

# 目 录

# Contents

01	安全说明
02	产品概述
	测量原理
	标准液配置
	溶氧标定
03	技术参数
04	安装尺寸
05	传感器安装
06	接线说明
08	按键说明
09	设置说明
13	维护说明
14	通信协议
16	故障排除

## 安全说明



**仪器应选择安装在室内或有防护装置的位置，周围不得放置易燃易爆的物品。**

- ◆ 仪器安装位置应选择便于用户及安装维护人员阅读仪器铭牌，便于使用、维护及检修的地方。
- ◆ 所有电力和管道连接必须符合国家和地方标准；仪表电源前端必须安装绝缘开关或者电路切断开关。
- ◆ 为了安全和避免外部信号对仪器造成干扰，仪表电源线应接在相应规格、带有地线标志、符合电器标准的插座内，且地线须确保良好接地。
- ◆ 仪器的内部电路详见接线图，电压和功率的额定值详见产品上的铭牌，用户电源容量必须满足仪器正常使用的要求。

### **变送器安装注意事项：**

- ◆ 避免变送器受阳光直射、避免变送器发生震动；
- ◆ 应将变送器安装在稍高于操作者平视位置，便于操作者浏览面板或进行控制操作；
- ◆ 为变送器箱体的开启和维护留出足够的空间。

### **传感器安装注意事项：**

- ◆ 将传感器安装在工艺的恰当位置，以保证获得具有代表性的测量结果。
- ◆ 将传感器安装在易于触及的位置，以方便对传感器进行定期清洁维护。
- ◆ 应避免将传感器安装在产生气泡聚集的位置，以防止干扰信号的产生。
- ◆ 将传感器安装在有代表性、良好的取样点附近，传感器和取样点之间的距离推荐最大值不超过 1.5m。

## 产品概述

荧光法溶解氧分析仪是一种常用的仪器设备，主要用来测定水中溶解氧，广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。荧光法溶解氧测量仪，采用先进的荧光法替代传统的膜式电极，不用更换膜片和填充电解液，减少了维护工作量，提高了工作可靠性，特别适用于污水处理领域恶劣的工况。此外，荧光法传感器不消耗氧气，所以没有流速和搅动的要求，也不受硫化物等物质的干扰。

## 测量原理

荧光法溶解氧仪是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。传感器前端的荧光物质是特殊的铂金属卟啉复合了允许气体通过的聚酯箔片，表面涂了一层黑色的隔光材料以避免日光和水中其它荧光物质的干扰。调制的蓝或绿光照到荧光物质上使其激发，并发出红光，由于氧分子的猝熄效应，激发红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。我们采用了与蓝或绿光同步的红光光源作为参比，测量激发红光与参比光之间的相位差，并与内部标定值比对，从而计算出氧分子的浓度，经过温度补偿输出最终值。

## 标准液配置

### 无氧水的制备

常温 20℃ 下，在烧杯内放入 250ml 蒸馏水，加入约 50mg 左右的无水亚硫酸钠（使其充分饱和），可加入适量的氯化钴（ $\text{CoCl}_2$ ）做催化剂，搅拌均匀后使用。

## 溶氧标定

- ◆ 进入低点标定菜单（出厂已标定），保持避光性良好后，将荧光法溶氧电极放入无氧水中，等待稳定后，按 ENTER 确认储存。
- ◆ 进入空气中标定，将荧光法溶氧电极带上遮光罩放入空气中，保持避光性良好后，等待稳定后，按 ENTER 确认储存。
- ◆ 或者进入高点标定，将溶氧电极放入已知溶液中，保持避光性良好后，等待稳定后输入此液体溶氧值，按 ENTER 确认储存。（2、3 任选一种标定）

## 技术参数

### ➤ 变送器技术参数



测量范围:  $0\sim 20\text{mg/L}$   
显示方式: LCD 液晶显示  
分辨率:  $0.01\text{ mg/L}$   
精确度:  $\pm 0.02\text{ mg/L}$   
重复性:  $\pm 0.3\text{mg/L}$   
稳定性:  $\pm 0.3\text{mg/L}$   
环境温度:  $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$   
相对湿度:  $(65\pm 20)\%$   
模拟输出:  $4\sim 20\text{mA}$ 、负载  $750\ \Omega$   
开关输出: 双路继电器、容量  $220\text{VAC}/5\text{ A}$   
数字信号: RS485  
供电电源:  $\text{AC}220\text{V}\pm 10\%$ 或  $\text{DC}24\text{V}$   
电源频率:  $(50\pm 0.5)\text{ Hz}$


### ➤ 传感器技术参数



防护等级: IP65  
名称: 电极  
测量范围:  $0\sim 20\text{mg/L}$   
温度范围:  $0\sim 60^{\circ}\text{C}$  (自动温补  $0\sim 99^{\circ}\text{C}$ )  
耐压:  $<0.6\text{MPa}$   
安装尺寸:  $3/4\text{NPT}$   
流速范围:  $0\sim 1\text{m/s}$ , 非磨损性流体  
安装方式: 支架浸没式、管道插入式  
防护等级: IP68

## 变送器安装

### ➤ 外形尺寸（安装尺寸标注在外壳后面）

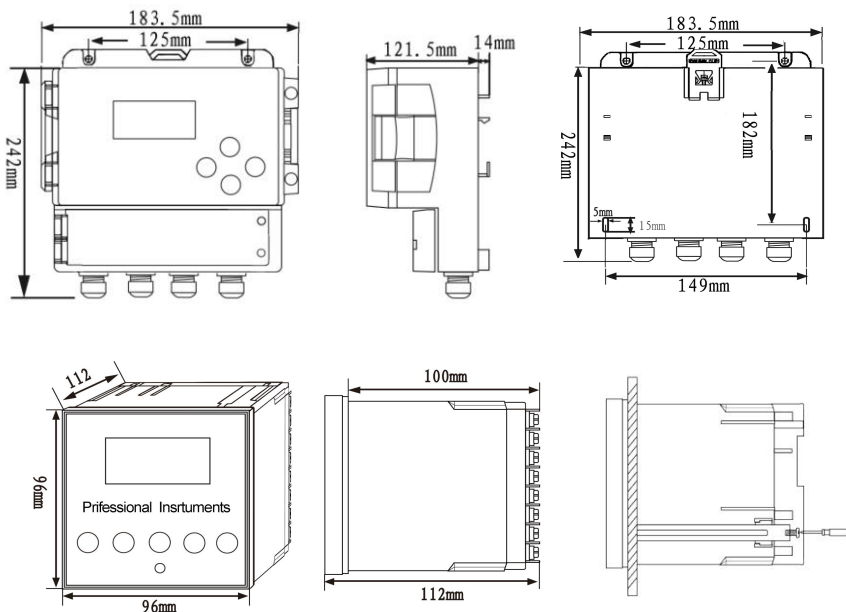


### ➤ 安装紧固

方式一：变送器背后有四个孔，尺寸如图所示，其中上面的孔用于悬挂，下面打开接线盖内的两个用于螺栓固定。

方式二：变送器可以在专用滑道上安装，有卡扣固定。

方式三：（盘装）开孔 91x91 的方孔后将仪表装入后，用紧固配件紧固即可。

### ▶ 支架浸没式安装（池顶）

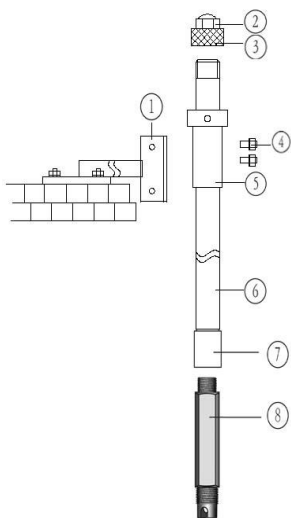

- 1、在池顶适当位置固定支架托。
- 2、按照左图的图示及序号，依次将支架零部件安装紧固；
- 3、所有零部件的螺纹处均缠生料带拧紧且需密封处理；
- 4、安装好的支架套入支架托中紧固。




**注意：**在连接传感器与安装管时，请旋转支架管而不要旋转传感器，否则传感器的电缆有可能被损坏。

浸没式安装时，传感器尽可能插入水中 50CM 以下或更多，以避免干扰。

- ① 支架托    ② 防水头  
③ 管盖    ④ 紧固螺丝  
⑤ 安装套管    ⑥ 支架管  
⑦ 管接头    ⑧ 传感器


### ▶ 插入式安装



- 1、电极    2、专用底座    3、管道

- 1、在管道合适位置按照底座尺寸开一个圆孔；
- 2、将专用底座焊接在管道孔处，焊接时焊点应饱满坚固；
- 3、可根据现场要求调节传感器深入管道的相应长度。
- 4、插入深度应保证探头与被测介质充分接触。

## 接线说明

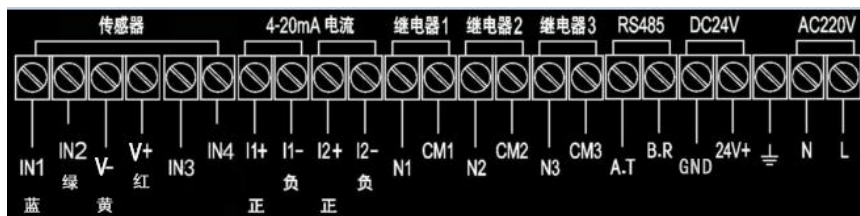

为了安全和避免外部信号对仪器造成干扰，仪表电源线应接在相应规格、带有地线标志、符合电器标准的插座内，且地线须确保良好接地。

序号	端子	功能	备注
(1)	蓝色 IN1	电极正接线端	传感器蓝色线
(2)	绿色 IN2	电极负接线端	传感器绿色线
(3)	黄色 V-	电极正接线端	传感器黄色线
(4)	红色 V+	电极负接线端	传感器红色线
(5)	IN3	输入正	备用
(6)	IN4	输入负	备用
(7)	I1+	4-20mA 输出正	电流 1 输出
(8)	I1-	4-20mA 输出负	
(9)	I2+	温度 4-20mA 输出正	0-100℃（选配）
(10)	I2-	温度 4-20mA 输出负	
(11)	N1	继电器 1 常开	均可 设置上下限报警
(12)	CM1	继电器 1 公共端	
(13)	N2	继电器 2 常开	
(14)	CM2	继电器 2 公共端	
(15)	N3	继电器 3 常开	备用
(16)	CM3	继电器 3 公共端	
(17)	A. T	RS485 A/RS232 T	RS485/RS232 输出（选配）
(18)	B. R	RS485 B/RS232 R	


(19)	GND	DC24V 输入负端	DC24V 输入
(20)	24V+	DC24V 输入正端	
(21)	PG	交流电源保护地	大地
(22)	N	交流电源输入 N	AC220V 输入
(23)	L	交流电源输入 L	




# 用户界面





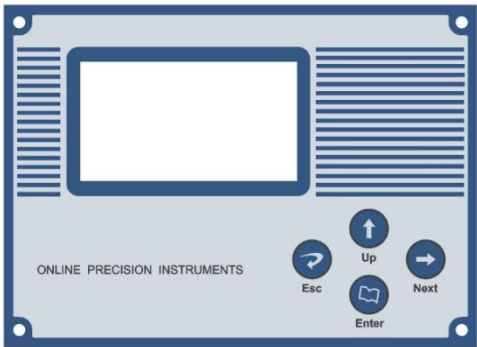

## 按键说明

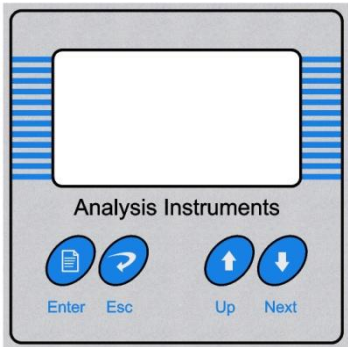

壁挂式




盘装式

按 键	说 明
 ENTER 菜单键	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 实现进入和退出设置状态的功能。</li><li>2. 通过该键可以实现从上级菜单进入下级菜单功能。</li><li>3. 当在参数修改完成后，按该键可以实现对修改参数的存储，并返回上级菜单。当在标定操作中，该键可以完成标定流程。</li></ol>
 UP 循环加键	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 该键可以对光标处的参数进行循环加的修改。</li><li>2. 当光标停留在参数项目上时，该键可以实现参数项之间的切换。</li><li>3. 进行数字输入时作为增加数字使用</li><li>4 可切换百分比</li></ol>
 NEXT 循环右移键	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 该键可以对参数的位进行选择，将光标移动到需要修改的参数位上。</li><li>2. 在参数末位时，可以返回参数项。</li><li>3. 快速查看继电器状态和设备号。</li><li>4. 长按 6s 再松开可快速查看标定信息。</li></ol>
 ESC 取消键	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 该键可以实现取消当前操作，返回上级菜单。</li><li>2. 返回主界面。</li></ol>

## 菜单及设置说明

显示界面：仪表开机后，首先显示的是测量模式。在测量模式下，仪表显示测量值、温度、时间、输出电流等信息。

### ➤ 测试模式界面

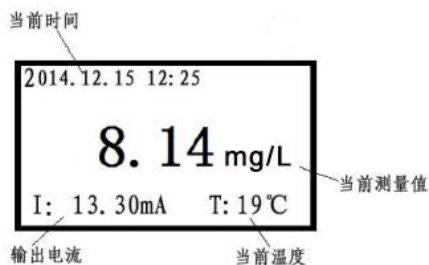

## 设置模式

按下 ENTER 键，进入仪表菜单，选择相应的菜单后按下 ENTER 键，进入到密码界面，输入密码“1001”，按 ENTER 键可进入对应子菜单，进入参数设置子菜单后，通过 NEXT 键移动光标，UP 键设置数值，通过 ENTER 键保存设置参数。

仪表菜单	分菜单项	范围	初始值
标定菜单	低点标定	无氧水	OFF
	空气中标定	空气	OFF
	高点标定	0-20mg/L	OFF
	电流 1 标定	4mA/20mA	4mA
	电流 2 标定	4mA/20mA	4mA
	温度修正	0-99.99℃	0
	动态修正	0-20mg/L	0
设置菜单	密码设置	0000-9999	1001
	语言设置	中文/英文	中文
	通讯设置	00~99 9600~115200	01 9600
	时间设置		当前 24h 时间

	单位设置	mg/L/ppm	Mg/L
	量程设置	0-20mg/L	20mg/L
	采样数据设置	00~99 Minute	00 Minute
	继电器一设置	关闭	OFF
	继电器二设置	关闭	OFF
	恢复出厂设置	\	\
	温度补偿	手动/自动/关闭	关闭
	压力补偿	实际要求设置	OFF
	盐度补偿	实际要求设置	OFF
	背光设置	Open\Close\5 Minute\10 Minute\1Hour	Open
查看菜单	通讯参数	/	/
	继电器信息	/	/
	程序版本	/	/
	历史数据	/	/

## 1. 标定菜单

1> 低点标定	<b>1&gt;低点标定</b> 电压值: 500mV 实际值: 0.50mg/L 采样数量: 200	等待采样稳定后, ENTER 保存, ESC 退出
2> 空气中标定	<b>2&gt;空气中标定</b> 电压值: 2170.0mV 实际值: 8.80mg/L 采样数量: 200	等待采样稳定后, ENTER 保存, ESC 退出
3> 高点标定	<b>3&gt;高点标定</b> 电压值: 2050.0mV 实际值: 7.32mg/L 采样数量: 200	等待采样稳定后, 通过 UP 键和 Next 键修改实际值, 把当前标定液的 DO 值输入, ENTER 保存, ESC 退出
4>电流 1 标定	<b>4&gt;电流 1 标定</b>	等待输出稳定后, 通过 UP 键和

	输出值: 4.00mA 实际值: 4.01mA 输出次数: 10	Next 键修改实际值,把当前测定的电流值输入, ENTER 保存, ESC 退出
5>电流 2 标定	<b>5&gt;电流 2 标定</b> 输出值: 4.00mA 实际值: 4.01mA 输出次数: 10	同电流 1 标定方式
6>温度修正	<b>6&gt;温度修正</b> 修正值: +00.00 等待输入 .....	通过 UP 键和 Next 键修改修正值, +代表正修正, -代表负值修正, ENTER 保存, ESC 退出
7>动态修正	<b>7&gt;动态修正</b> 修正值: +00.00 等待输入 .....	通过 UP 键和 Next 键修改修正值, +代表正修正, -代表负值修正, ENTER 保存, ESC 退出

## 2. 设置菜单

1>密码设置	<b>1&gt;密码设置</b> 请输入原密码 请输入新密码 再次输入新密码	根据菜单提示, 通过 UP 键和 NEXT 键输入, 进行相应步骤操作, ENTER 保存, ESC 退出
2>语言设置	<b>2&gt;语言设置</b> 1、中文    2、英文	通过 UP 键选择语言类型, ENTER 保存, ESC 退出
3>通讯设置	<b>3&gt;通讯设置</b> 输入设备号    01 波特率: 9600	根据菜单提示, 先通过 UP 和 NEXT 键输入设备号, ENTER 确认后, 选择波特率, ENTER 保存, ESC 退出
4>时间设置	<b>4&gt;时间设置</b> DATE: 19-01-01 TIME: 19-15-11	通过 UP 键和 NEXT 键改变当前时间, 修改完对应项后按 ENTER 转换下一项, 最后 ENTER 保存, ESC 退出
5>单位设置	<b>5&gt;单位设置</b>	mg/L/ppm 可以任意切换
6>量程设置	<b>6&gt;量程设置</b>	通过 UP 键和 Next 键修改数值,

	0-20mg/L	ENTER 保存, ESC 退出
7>采样数据设置	6>采样数据设置 00 Minute	通过 UP 键和 NEXT 键改变数据的间隔时间, 选择为 00 Minute, 表示不保存。ENTER 保存, ESC 退出
8>继电器 1 设置	7>继电器 1 设置 关闭 阈值: 00.10 回值: 00.50	继电器可以设置为关闭/低报/高报三种类型, 通过 UP 键更改。阈值为报警的设定值, 当高报时, 测量值低于阈值减去回值后取消报警; 当低报时, 测量值大于阈值加上回值后取消报警。
9>继电器 2 设置	8>继电器 2 设置	同继电器 1 设置
10>恢复出厂设置	9>恢复出厂设置 恢复出厂设置值	通过 UP 键选择相应选项, ENTER 保存, ESC 退出
11>温度补偿	10>温度补偿 手动/关闭/自动 设定值: 00℃	通过 UP 键选择相应选项, 当手动补偿时将设定值输入即可, ENTER 保存, ESC 退出
12>压力补偿	11>压力补偿 关闭 设定值: 000.00	通过 UP 键选择相应选项, ENTER 保存, ESC 退出
13>盐度补偿	12>盐度补偿 关闭 设定值: 000.00	通过 UP 键选择相应选项, ENTER 保存, ESC 退出
14>背光设置	13>背光设置 模式: Open	背光模式有 Open/Close/5 Minute/10 Minute/1Hour, 通过 UP 键选择, ENTER 保存, ESC 退出

### 3. 查看菜单

1>通讯参数	1>通讯参数
--------	--------

	设备号：01	波特率：9600
2>继电器信息	2>继电器信息	
	继电器 1:关闭	继电器 2:关闭      继电器 3:关闭
3>程序版本	3>程序版本	
	当前程序版本号 H030S20RV201105	
4>历史数据	4>历史数据	
	2017.12.21 12.25.00 7.52mg/L	
	2017.12.25 14.25.00 8.52mg/L	

## 维 护

### 变送器维护

变送器根据使用的要求，安装位置和工作情况比较复杂，为了使变送器正常工作，维护人员需要对变送器进行定期维护，维护时请注意如下事项：

- ◆ 安装在室外请检查变送器安装箱体是否有漏水等现象；
- ◆ 检查变送器的工作环境，如果温度超出变送器的工作稳定范围，请采取相应措施，否则变送器可能会损坏或导致其使用寿命降低；
- ◆ 清洁变送器的塑料外壳时，请使用软布和柔和的清洁剂，注意不要让湿气进入变送器内部；
- ◆ 检查变送器显示数据是否正常；
- ◆ 检查变送器接线端子上的接线是否牢固，注意在拆卸接线盖前应先将 220V 交流电源断开。

### 传感器维护

为了获得最好的测量效果，传感器需要进行定期维护，维护时请注意如下事项：

- ◆ 传感器上的光束发送和接收窗口都需要清洗，请维护人员根据经验定时清洗传感器，确保传感器光束窗口的清洁。清洗时，断开电源，拧下传感器前端罩子，用软布擦除罩子内和传感器光窗上的污物，并用清水冲洗干净，最后再将罩子拧紧即可；
- ◆ 检查传感器的电缆，正常工作时电缆不应绷紧，否则容易使电缆内部电线断

裂，引起传感器不能正常工作；

- ◆ 检查传感器的外壳是否因腐蚀或其他原因受到损坏。
- ◆ 传感器荧光帽为精密易磨损部件，切忌使用锐物刮洗。如果漏光面积超过三分之一，需更换新的荧光帽。

## 通信协议

仪表提供串行异步半双工 RS485 通信，采用 MODBUS-RTU 规约，测量数据均可读出，每个仪表可设定其通信地址，通信连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线，线径不小于  $0.5\text{mm}^2$ 。布线时应使通信线远离强电缆或其他强电场环境，推荐采用 T 型网络的连接方式，不建议采用星形或其他连接方式。

MODBUS\_RTU 通信协议：MODBUS 协议在一根通信线上采用主从应答方式的通信连接方式。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机，就是在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流（半双工的工作模式）。

MODBUS 协议只允许在主机（PC、PLC 等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通信线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

主机查询：查询消息帧包括设备地址、功能代码、数据信息码、校准码；

地址码：表明要选中的从机设备地址；

功能代码：表明被选中的从机设备要执行何种功能；

数据段：包含了从设备要执行功能的任何附加信息；

校验码：用来检验一帧信息的正确性，采用 CRC16 校准规则；

从机响应：如果从设备产生一正常的回应，在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和 CRC16 校验码。数据信息码则包括了从设备收集的数据，如参数测量值；

硬件连接：将信号线对应连接到变送器的 A、B 端子上；

通信设置：仪表规定采用通信格式为 9600，N，8，1（1 个起始位、8 个数据位、无校验、1 个停止位），响应速度为 0.015S；

通信命令：功能码 03—用来读取当前显示的测量值。

## 通信协议

### ➤ 上位机发送命令

字节	发送	示例	备注
0	地址	0x01	
1	功能码	0x03	
2	寄存器 起始地址高位	0x00	0000~0003
3	寄存器 起始地址低位	0x00	
4	寄存器个数高位	0x00	0001~0004
5	寄存器个数低位	0x04	
6	CRC 校验码低位	0x44	
7	CRC 校验码高位	0x09	

### ➤ 设备响应

字节	回应	示例
0	地址	0x01
1	功能码	0x03
2	发送数据字节数	0x08
3	D0 测量值	0x40
4	D0 测量值	0xE8
5	D0 测量值	0xF5
6	D0 测量值	0xC3
7	温度测量值	0x41
8	温度测量值	0x80
9	温度测量值	0x00
10	温度测量值	0x00
11	CRC 校验码高位	0x16
12	CRC 校验码低位	0x10



➤ MODBUS 通信协议的地址和数据对应表（十六进制）：

地址	参数描述	数据类型	说明
0000 ~ 0001	D0 测量值	float	第一字节为浮点高位，例如： 40 E8 F5 C3 为 0x40E8F5C3 对应的浮点数为 7.28。
0002 ~ 0003	温度测量值	float	第一字节为浮点高位，例如： 41 80 00 00 为 0x41800000 对应的浮点数为 16.00。

**注：每个寄存器返回两个字节的數據。**

**示例 1：**仪表的 Modbus 通讯地址为 01（十进制）；要读取 D0 值，T 值。

**PC 主机发送：**01 03 00 00 00 04 44 09

变送器返回：01 03 08 40 E8 F5 C3 42 18 9E E4 16 10  
数量 D0 温度 CRC

CRC 校验码参照 Modbus 标准协议的计算方式。

## 故障排除

现象	可能存在原因	解决方案
显示屏无显示	仪表或液晶屏供电故障	检查电源是否连接；检查传感器的电源线是否接反，观察供电灯是否正常
模拟电流无输出	电流模块故障或接线故障	请检查电流输出接线是否正确。请参照说明书或仪表外壳中接线端子图
输出电流与显示电流不符合	电流输出没有进行正确的校准	请重新对 4mA 与 20mA 输出进行校准；请参照菜单设置中的电流校准 1。
错误码 Er2	测量值太小	检查传感器连线以及是否有遮挡或重新进行标定操作
错误码 Er3	测量值超出范围	检查量程设置是否合理
错误码 Er4	主机与传感器测量通讯不上	检查仪表接线或传感器信号线是否破损

仪表显示值与实际值有偏差	传感器有污垢	对传感器定时进行清洗
	长时间未标定	按照标定方式对仪表进行标定
继电器状态有误	继电器报警值类型选择不正确；	按电气连接正确选择继电器报警值，并进行正确设置
	继电器报警的开关量输出信号线的接线不正确	请按接线指示图正确接线；
通信故障	信号线接线不正确	请按接线指示图正确接线
	信号传输距离过长或信号传输线缆不符合安装要求；	缩短信号传输距离或选择符合安装要求的线缆
	通信协议或设置有误	参照通讯协议章节重新设置
	安装不符合要求	电极必须安装大于水下 50cm，四周无遮挡，无干扰
	标定不正确	按步骤重新标定
测量值在中控显示波动	未使用屏蔽线缆	按要求使用有效屏蔽线缆
	现场有干扰	增加隔离器设备保护